ТСР 21-01-39

Артикул		Наименование	Размер (см)	Упаковка (шт)
	422145 VMT CURVE	Пластина-полукольцо VARIMATE (ВАРИМЕЙТ) адгезивная для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников: тонкая изогнутая	3 x 9	60
	422148 VMT 0511	Пластина-полукольцо VARIMATE (ВАРИМЕЙТ) адгезивная для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников: тонкая	5 x 11	30
	422146 VMT 0311	Пластина-полукольцо VARIMATE (ВАРИМЕЙТ) адгезивная для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников: тонкая	3 x 11	60

РУ № РЗН 2020/9565 от 21.01.2020 г.

Информационная Линия Поддержки ConvaTec для стомированных людей

Специалисты **Информационной Линии Поддержки ConvaTec для стомированных людей** помогут ответить на следующие вопросы:

- как правильно использовать продукцию ConvaTec для стомированных людей
- как получить продукцию ConvaTec на основе социальных льгот и гарантий
- как приобрести продукцию ConvaTec в розничных точках продаж
- как можно оформить подписку для получения материалов ConvaTec

За дополнительной информацией вы можете обратиться по адресу:
115054 г. Москва, Космодамианская наб., д. 52, стр. 1, 9 этаж
тел.: +7 (495) 663-70-30, факс: +7 (495) 748-78-94

www.convatec.ru
www.convatec-russia.ru

8-800-200-80-99
звонок по России бесплатный
Информационная Линия Поддержки ConvaTec для стомированных людей
Часы работы: понедельник-пятница, 9:00–17:00

ConvaTec

Varimate

ТОНКАЯ АДГЕЗИВНАЯ ПЛАСТИНА-ПОЛУКОЛЬЦО

- ✓ Легкость использования и надежность фиксации
- ✓ Повышает чувство безопасности и уверенности в себе

Варимейт (Varimate) тонкая адгезивная пластина-полукольцо*

Рекомедации по использованию:

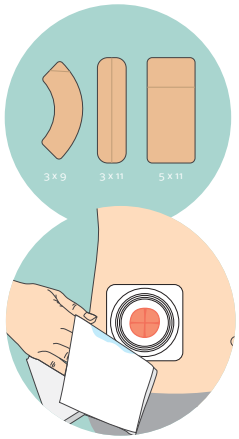

Подготовка:

1. Выберите платину-полукольцо подходящего вам типа и размера
2. Очистите кожу теплой водой с нейтральным мылом. Просушите. Слегка влажная кожа будет способствовать лучшему приклеиванию пластины-полукольца
3. Наложите пластину калоприемника/уроприемника

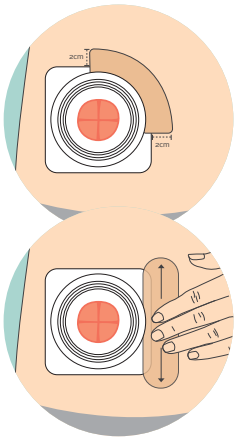

Наложение пластины-полукольца:

1. Удалите половину бумажной подложки пластины-полукольца Varimate
2. Наложите пластину-полукольцо Varimate поверх внешних краёв адгезивной пластины калоприемника/уроприемника
3. Пластина должна перекрывать кожу, граничащую с адгезивной пластиной каллоприемника/ уроприемника не менее чем на 1,5–2 см
4. Разгладьте возможные неровности. Прижимайте к телу пластины-полукольца Varimate около 30 секунд
5. При использовании двухкомпонентных систем по уходу за стомой, присоедините сборный мешок к пластине калоприемника/уроприемника



Удаление пластины:

1. Придерживая кожу, аккуратно удалите пластину-полукольцо с кожи.
2. Дополнительно возможно использование средств для удаления адгезива (Нилтак)**

* Инструкция по применению медицинского изделия Пластина-полукольцо VARIMATE (ВАРИМЕЙТ) адгезивная для дополнительной фиксации пластин калоприемников уроприемников
** Инструкция по применению медицинского изделия Очиститель для кожи КонваТек Нилтак (ConvaTec Niltac)

5 причин

для активного использования адгезивной пластины-полукольца Varimate

Надежно фиксирует

- Надежно закрепляет адгезивную пластину
- Предотвращает протекание
- Предотвращает прилипание к одежде края адгезивной пластины (при ее расширении)

Благоприятна для кожи

- Состоит из благоприятного для кожи гидроколлоида
- Дышащее тонкое полиуретановое покрытие предотвращает высыхание края адгезивной пластины и повреждение им кожи
- Не содержит латекс и другие синтетические примеси

Водоотталкивающее покрытие

- Позволяют использовать во время водных процедур и плавания

Гибкая и тонкая

- Не сковывает движений, повторяет движения тела

Проста в использовании

- Легко наложить и легко снять

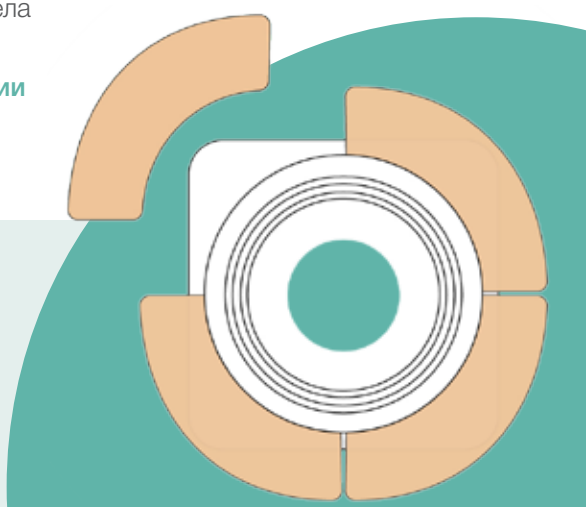

✓ Легкость использования и надежность фиксации

✓ Повышает чувство безопасности и уверенности в себе